

Начальнику установи - лікареві  
**Аллі ГАЛЕЄВІЙ**

## ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

### Про технічне обслуговування обладнання

Прошу Вас дозволити провести ремонт і технічне обслуговування згідно інструкції користувача автоматичного **експрес-аналізатора InnovaStar** в клініко-діагностичній лабораторії лабораторного відділення ДК 021:2015 - 50420000-5.

Перелік робіт:

- Розбирання та збирання аналізатору
- Очищення зовнішніх та внутрішніх поверхонь
- Діагностика електричної, механічної, гідравлічної та вимірювальних систем аналізатора
- Заміна трубки голка-термостат
- Заміна трубки термостат-проточна кювета
- Очищення або заміна конектора відходів
- Очищення промивної камери
- Перевірка та налаштування підйомника та касети
- Заміна шприця дилютора
- Очищення голки для відбору зразків
- Очищення затискача
- Перевірка та налаштування галогенної лампи
- Оновлення програмного забезпечення

Начальник лабораторного  
відділення-лікар

**Юлія КОРЯВЕЦЬ**



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-441 від 13.08.2024 (5022)

Підписав: Корявець Юлія Петрівна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000DC6255012A00F304


Дійсний: з 19.03.2024 06:06:35 по 19.03.2025 21:59:59

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ  
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»**

**Комерційна пропозиція**

Медична компанія «ЕМПІРИКА», професійний постачальник лабораторного обладнання в Україні та офіційний дистриб'ютор компанії **DiaSys Diagnostic System (Німеччина)**, висловлює Вам свою повагу та пропонує сервісні послуги щодо лабораторного обладнання, а саме:

**Послуга з технічного обслуговування автоматичного експрес-аналізатора InnovaStar  
(DiaSys Diagnostic System, Німеччина)**

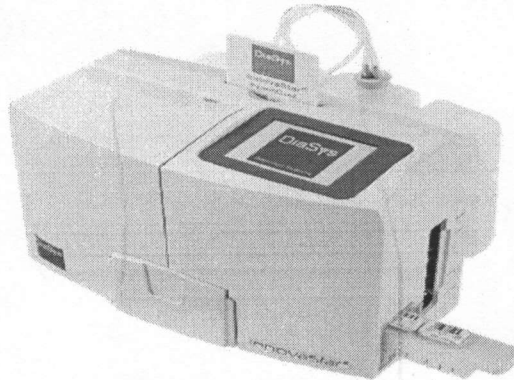

**Перелік послуг:**

Розбирання та збирання аналізатору	
Очищення зовнішніх та внутрішніх поверхонь	
Діагностика електричної, механічної, гідравлічної та вимірювальних систем аналізатора	
Гідравлічна система, камери	Заміна трубки голка-термостат
	Заміна трубки термостат-проточна кювета
	Очищення або заміна конектора відходів
	Очищення промивної камери
	Перевірка та налаштування підйомника та касети
Реакційний блок	Заміна шприця дилютора
	Очищення голки для відбору зразків
	Очищення затискача
Фотометричний блок	Перевірка та налаштування галогенної лампи
Програмне забезпечення	Оновлення програмного забезпечення

№	Найменування	Ціна з ПДВ, грн
1	Послуга з технічного обслуговування автоматичного експрес-аналізатора InnovaStar	29 362,80

*Всі необхідні витратні матеріали та запчастини включено у вартість обслуговування.*

**Разом, грн: 29 362,80**

**У тому числі ПДВ, грн: 4 893,80**

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Вх. № 519

«13» 08 2024 р.

Кількість арк. \_\_\_\_\_

Осн. док. « \_\_\_\_\_ » Дод. « \_\_\_\_\_ »

**З повагою,  
ТОВ «Медична компанія «Емпірика»**

## ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

### Послуги з технічного обслуговування автоматичного експрес аналізатора InnovaStar (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

*Перелік послуг:*

Розбирання та збирання аналізатору	
Очищення зовнішніх та внутрішніх поверхонь	
Діагностика електричної, механічної, гідравлічної та вимірювальних систем аналізатора	
<b>Гідравлічна система, камери</b>	Заміна трубки голка-термостат
	Заміна трубки термостат-проточна кювета
	Очищення або заміна конектора відходів
	Очищення промивної камери
	Перевірка та налаштування підйомника та касети
<b>Реакційний блок</b>	Заміна шприця дилютора
	Очищення голки для відбору зразків
	Очищення затискача
<b>Фотометричний блок</b>	Перевірка та налаштування галогенної лампи
<b>Програмне забезпечення</b>	Оновлення програмного забезпечення

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (гарантійний лист надається).
2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).
3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).
4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).
5. Стабільність та надійність послуги підтверджується Виконавцем гарантією якості. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника (гарантійний лист надається).
6. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 5 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).

7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.