

Начальнику ДУ «ТМО МВС України
по Чернігівській області» - лікареві
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Про необхідність придбання
Спінальної рамки до операційного столу**

Для надання якісної кваліфікованої медичної допомоги під час виконання оперативних втручань у пацієнтів хірургічного (нейрохірургічного) профілю у зв'язку з наявністю кваліфікованого спеціаліста для проведення відповідних втручань та згідно з Переліком медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 травня 2022 року № 761 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 листопада 2022 року № 2263) прошу провести закупівлю Спінальної рамки до операційного столу з медико-технічними вимогами, що додаються.

Додаток: на 2 арк. в електронному вигляді

Начальник лікарні - лікар

Наталія МИКОЛЮК



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-465 від 23.08.2024 (5203)

Підписав: Миколюк Наталія Андріївна

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000FFB232005A91D700

Дійсний: з 07.08.2024 13:29:05 по 07.08.2026 13:29:05

Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Спинальна рамка до операційного столу (код за ЕЗС ДК 021:2015:33160000 - 9
Устаткування для операційних блоків) (код за НК 024:2023:58878 Форма
автономна для позиціонування пацієнта багаторазового використання))

№	Найменування предмету закупівлі або еквівалент	Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Одиниця виміру	Кількість
1.	Спинальна рамка до операційного столу	58878 Форма автономна для позиціонування пацієнта багаторазового використання	компл.	1

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій з оригіналів документів або завірених учасником копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців (надати гарантійний лист від Учасника).

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико-технічні вимоги:

№	Характеристики	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника
1.	Спінальна рамка до операційного столу	1 компл.	
1.1.	Спінальна рамка з кріпленням до операційного столу призначена для позиціонування пацієнта під час нейрохірургічних та травматологічних втручань включаючи ламінектомію, декомпресію та хірургію міжхребцевих дисків	Відповідність	
1.2.	Конструкція виробу має бути сумісною для використання з С-дугою	Відповідність	
1.3.	Можливість регулювання за висотою під час операції	Відповідність	
1.4.	Спінальна рамка повинна складатись з наступних компонентів: <ul style="list-style-type: none"> - пластини з вуглецевого волокна; - гелеві накладки на пластини; - кривошипна рукоятка для регулювання вигину; - з'єднувач кривошипної рукоятки; - ремені фіксації до столу (силіконові, без липучок); - рукоятка для перенесення; - кнопки для медіального/латерального слайдингу. 	Відповідність	

1.5.	Виріб повинен бути сумісним з операційними столами стандартів Європи, США та Великої Британії.	Відповідність	
1.6.	Можливість фіксації до столу без бокових рейок	Відповідність	
1.7.	Матеріали конструкції спінальної рамки:	Нержавіюча сталь, алюміній та вуглецеве волокно	
1.8.	Вага конструкції	Не більше 12 кг	
1.9.	Допустима вага пацієнта	Не більше 272 кг	
1.10.	Розміри виробу Д*Ш*В	75*45*25 см +/-5%	
1.11.	Матеріали рамки стійкі до очищення та дезінфекції рекомендованими заводом виробником речовинами	Відповідність	

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз *«або еквівалент»*.

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис
уповноваженої особи Учасника,
завірені печаткою (за наявністю).*

вих. № 1214/08-24
від 19.08.2024 р.

м. Чернігів

Уповноваженій особі
Державна установа
«Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД», надає наступну комерційну пропозицію:


Найменування: Каркас для вигину хребта КТЕК, що комплектується:

- КТЕК9000 Каркас для вигину хребта КТЕК - 1 шт;
- КТЕК9010 Ручка криволінійної форми КТЕК - 1 шт

Одиниця виміру: шт

Кількість: 1

- Забезпечує стабільну платформу для операцій на хребті, включаючи ламінектомію, декомпресію та хірургію міжхребцевих дисків
- Регулюється на потрібну висоту під час операції для отримання оптимального доступу до хірургічного поля
- Сумісний з С-дугою
- Підходить до рейок і стільниць столів для операцій на хребті
- Унікальні силіконові ремені забезпечують краще очищення порівняно з ременями на липучках
- Вигнута рукоятка для регулювання в комплекті (1 шт.)
- Допустима вага пацієнта: 272 кг
- Вага пристрою: 11 кг

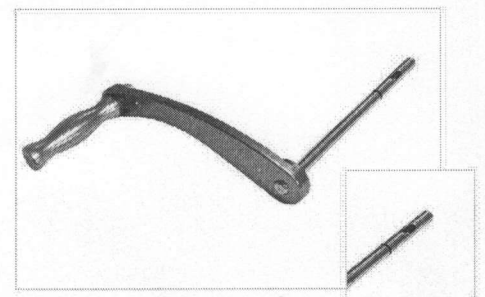

Виробництво: Kyra MEDICAL (США).

Всього з ПДВ: 575 000,00 грн. (П'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»	ТОВ «Сівер-МЕД» 14005, м. Чернігів, Проспект Миру 44
Відділ продажів: (073) 103-10-08, Відділ сервісу: (073) 103-10-38, siver-med@ukr.net, www.siver-med.com	
« 19 » ЄДРПОУ 35194534, ІВАН ДА 328510050000026006129539400, в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005	
Кількість арк. _____	
Осн. док. « _____ »	Дод. « _____ »

**ТОВ "Науково-виробниче підприємство
" Академія медтехнологій "**

02094, м. Київ, просп. Гагаріна, 14., оф. 32

т/ф +38 (044) 573-31-50, +38 (066) 050-32-09


E-mail: alkoservis@bigmir.net

№88


Від 20.08.2024

ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

Комерційна пропозиція

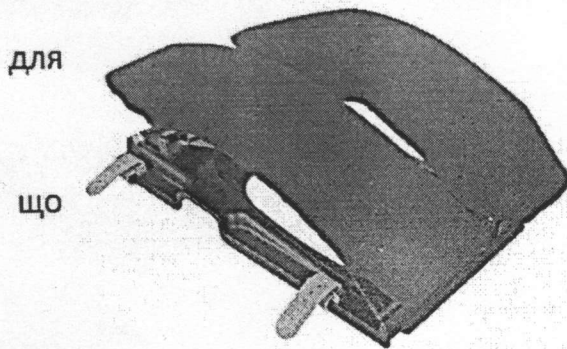

Каркас
вигину
хребта
КТЕК,

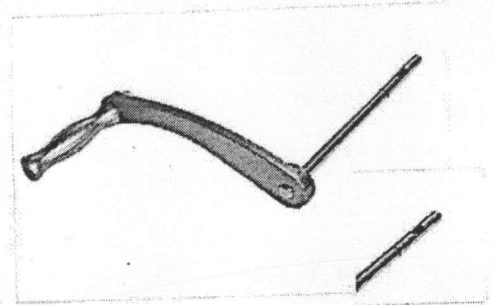

комплектуються: 1. КТЕК9000 Каркас для
вигину хребта КТЕК - 1 шт; 2. КТЕК9010 Ручка криволінійної форми КТЕК - 1 шт.

(Куга MEDICAL (США))


Особливості

- Забезпечує стабільну платформу для операцій на хребті, включаючи ламінектомію, декомпресію та хірургію міжхребцевих дисків
- Регулюється на потрібну висоту під час операції для отримання оптимального доступу до хірургічного поля
- Підходить до рейок і стільниць столів для операцій на хребті
- Унікальні силіконові ремені забезпечують краще очищення порівняно з ременями на липучках
- Допустима вага пацієнта: 272 кг

589 680,00 грн. з ПДВ.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»		
Вх. №	524	
« 20 »	08	2024 р.
Кількість арк.		
Осн. док. «	»	Дод. «

Директор



Л.М. Гордієнко


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАНСМЕДЦЕНТР»

П/р № UA763510050000026008571652900 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 39872208, ПІН 398722026530. Email: tmckmi@ukr.net, тел. (096) 466-28-50

№ 521
від 20.08.2024

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Комерційна пропозиція

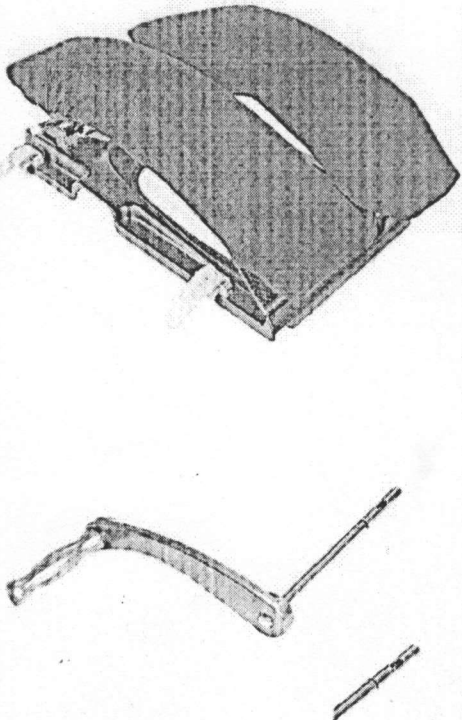Найменування	Зображення	К-сть	Ціна за одиницю з ПДВ, гривень.
<p>Каркас для вигину хребта КТЕК, що комплектується: - КТЕК9000 Каркас для вигину хребта КТЕК - 1 шт; - КТЕК9010 Ручка криволінійної форми КТЕК - 1 шт</p> <p>Коротка характеристика Забезпечує стабільну платформу для операцій на хребті, включаючи ламінектомію, декомпресію та хірургію міжхребцевих дисків. Регулюється на потрібну висоту під час операції для отримання оптимального доступу до хірургічного поля. Сумісний з С-дугою. Підходить до рейок і стільниць столів для операцій на хребті. Унікальні силіконові реміні забезпечують краще очищення порівняно з ремінями на липучках. Вигнута рукоятка для регулювання. Допустима вага пацієнта: 272 кг Вага пристрою: 11 кг Виробник: Kyra MEDICAL. Країна виробника: США</p>		1 шт	584 220.00

Генеральний директор



Кіяшко М. І.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Вх. № 525
« 20 » 08 2024 р.

Кількість арк. _____

Осн. док. « » Дод. « »