



вих. №110 від 17.02.2022р

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «СМАТУМ МЕДІКАЛ» є ексклюзивним дистрибутором вітчизняного виробника медичних товарів під торговою маркою Medicalspan та пропонує розглянути комерційну пропозицію від нашої компанії на набори швидких тестів для діагностики антигену коронавірусу SARS-CoV-2, виробництва компанії **SD BIOSENSOR, INC.** (Південна Корея) **Standart I-Q COVID-19 Ag Home test** :

<p>Набір експрес-тестів на наявність антигену Standart I-Q COVID-19 Ag Home test компанії «SD BIOSENSOR, INC.». 25 шт</p> 		6250грн/упаковка
--	---	------------------

Тест STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test для визначення антигену - це швидкий хроматографічний імунологічний аналіз для якісного виявлення специфічних структурних антигенів SARS-CoV-2 в назофарингеальному або назальному мазках.

Тести Standart I-Q COVID-19 Ag Home test :

- 1.Зареєстровані в Україні згідно з чинного законодавства
- 2.Мають декларацію про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту
- 3.Внесені до Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг
- 4.Верифіковані лабораторією Центру громадського здоров'я або обласним лабораторним центром МОЗ України
- 5.Відповідають медико-технічні вимогам згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.2020 № 2665
 - 6.Призначені як для професійного використання так і для самоконтролю.
 - 7.Прості у використанні та передбачають мінімальну кількість операцій.

Тип зразку

- Назофарингеальний мазок або назальний мазок

Переваги тесту на антиген

- **Ефективність:** процедура тестування вимагає мінімальної підготовки та не потребує ніякого обладнання для тестування.
- **Надійність:** Він може забезпечити чіткий результат протягом 15-30 хвилин та має вбудований контроль процедури.
- **Місце проведення:** може забезпечити швидкі результати при скринінгових дослідженнях


Характеристики

Клінічні значення

Чутливість - 94.94% (75/79), (95% CI: 87.54% - 98.60%) ,

Специфічність – 100% (217/217), (95% CI: 98.31% - 100%)

Інтерпретація отриманих результатів

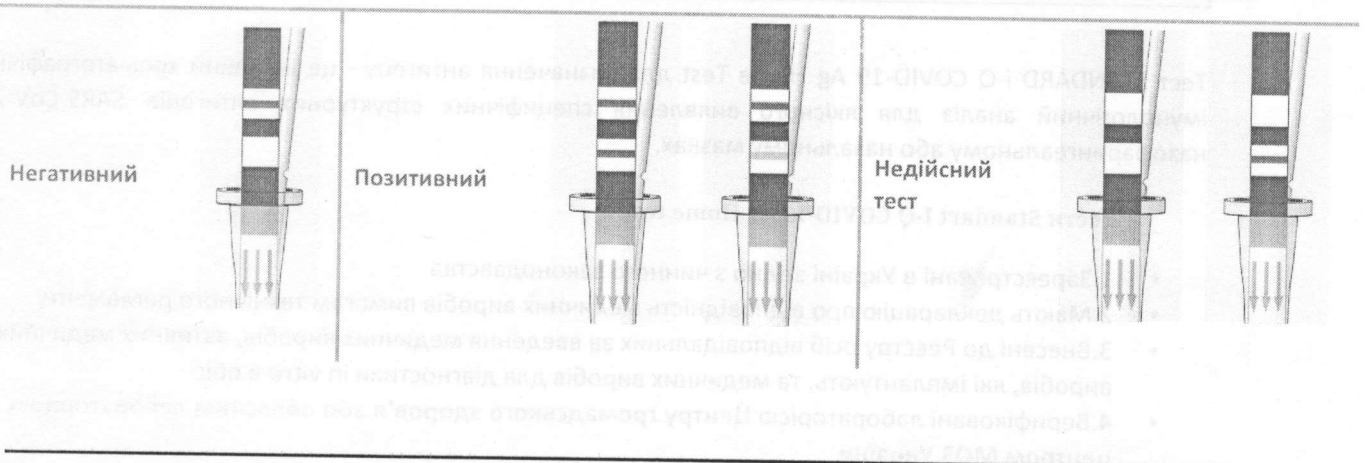

З повагою,
Генеральний директор



М.В. Печеник