


Начальнику ДУ «ТМО МВС України  
по Чернігівській області» – лікарю  
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

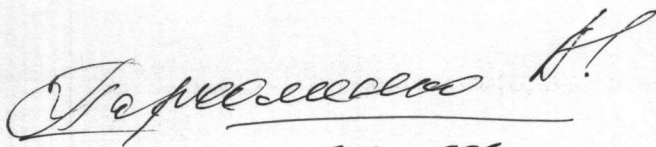

Про необхідність придбання  
медичного діагностичного  
обладнання

### Доповідна записка

Для розвитку служби функціональної діагностики установи та підвищення діагностичної спроможності кабінету прошу придбати прилад добового моніторингу артеріального тиску, оскільки один наявний прилад не забезпечує потреб установи.

Бажані характеристики приладу для добового моніторингу артеріального тиску:

- метод вимірювання – осцилометричний;
- діапазон вимірювання АТ – 20-180 mmHg;
- діапазон вимірювання частоти серцевих скорочень – 30-180 уд/хв;
- точність вимірювання АТ –  $\pm 3$  mmHg;
- точність вимірювання ЧСС –  $\pm 5$  %;
- можлива тривалість моніторингу – 24-72 години;
- передача даних на комп'ютер – бездротова;
- наявність екрану на приладі – бажана;
- габарити приладу (реєстратора) – максимальний розмір не більше 100 мм;
- маса реєстратора (без манжети і портупеї) – не більше 150 г;
- живлення – акумулятор (змінний або вбудований);
- програмне забезпечення для аналізу – сумісне з операційною системою Microsoft® Windows® 10, керівництво з експлуатації та інтерфейс програми – україномовні;
- можливість автоматичного аналізу результатів ДМАТ для дорослих та для дітей.

Застосування такого приладу дозволить удвічі збільшити пропускну спроможність кабінету функціональної діагностики щодо виконання моніторингу АТ та забезпечити такою діагностикою як дорослих, так і дітей.

Лікар з функціональної діагностики



Олександр ЗАГЛЯДА

06.06.2023 року

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»		
Вих. №	33/45-262	
« 06 »	06	20 23 р.
Кількість арк.	_____	
Осн. док. «	»	Дод. «