

Начальнику ДУ «ТМО МВС України по
Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Доповідна записка

Про необхідність придбання мийно дезінфекційної
машини для поліклініки
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

З метою дотримання вимог наказу МОЗ України № 552 від 11 серпня 2014 року "Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я», наказу МОЗ України №761 від 09.05.2022 «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану», високих стандартів інфекційного контролю та санітарно-епідеміологічного режиму, а також забезпечення якісного механізованого, безпечного процесу дезінфекції та миття медичних інструментів існує потреба в придбанні мийно-дезінфекуючої машини для стоматологічного кабінету поліклініки за кодом НК 024:2023-35424.

Сестра медична
старша поліклініки

Олена МИХАЙЛІЧЕНКО

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-163 від 14.02.2025 (8382)

Підписав: Михайліченко Олена Юріївна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000B47C2401A0FB7A05

Дійсний: з 07.10.2024 08:28:45 по 07.10.2025 20:59:59



ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Мийка-дезінфікатор (код за ЕЗС ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) (код за НК 024:2023:35424 Машина мийна/ дезінфікувальна для хірургічних інструментів/устаткування))

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Мийка-дезінфікатор	шт.	1

Загальні вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам (опису предмета закупівлі) викладених у даному додатку до Документації.
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановлених в технічних вимогах, викладених у даному додатку до Документації, повинні бути обов'язково підтверджені посиланням на сторінку(и) технічного документу виробника (інструкція по застосуванню, та/або технічний паспорт, та/або каталог, брошура та/або інший документ, що містить технічні характеристики товару тощо українською мовою), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановлених в медико-технічних вимогах, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
- Запропоноване обладнання повинно бути новим та таким, що не перебувало раніше в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).
- Обладнання, запропоноване Учасником, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

Завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

4. Гарантійний термін на обладнання – не менше 12 місяців (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

5. Учасник повинен бути спроможним забезпечити поставку товару, що є предметом закупівлі цієї процедури закупівлі відповідної якості, в обсягах та в терміни у відповідності до вимог тендерної документації.

Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, якості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

6. Проведення доставки, інсталяції та запуску обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

7. Інструктаж спеціалістів замовника за рахунок учасника (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

Медико-технічні вимоги:

№ з/п	Медико-технічна вимога	Відповідність (Так/Ні) з посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1.	Мийка-дезінфікатор призначена для використання в медичній сфері.	
2.	Прилад використовується для очищення та дезінфекції медичних інструментів для підготовки перед повторним використанням або перед подальшим етапом повторної обробки, наприклад стерилізацією в автоклаві.	
3.	Висота мийки не менше 124 см	
4.	Ширина мийки не більше 59,8 см	
5.	Довжина мийки не менше 67,8 см	
6.	Вага приладу, не більше 110 кг	
7.	Розміри камери для промивання, (В x Ш x Д) 29 x 45,5 x 42,3 ± 2 см	
8.	Об'єм камери для промивання, не менше 80 л	
9.	Камера для промивання виготовлена з нержавіючої сталі	
10.	Можливість проведення автоматичної обробки очищення термостійких медичних інструментів (витримують температуру до 95 °С)	
11.	Очищення інструментів здійснюється за допомогою води і технологічного засобу для очищення.	
12.	Остаточна дезінфекція інструменту відбувається за допомогою термічної дезінфекції.	
13.	Для кожного технологічного засобу передбачена окрема ємність (каністра).	
14.	Об'єм ємності для ополіскувача не менше 1л	
15.	Об'єм ємностей для нейтралізатора та очисника не менше 5 л.	
16.	Дозування технічних засобів здійснюється за допомогою дозувального насосу.	
17.	Всі деталі приладу, через які проходить вода, виготовлені з нержавіючих матеріалів	
18.	Наявність панелі управління, що складається з світлодіодного дисплею для відображення інформації та чотирьох мембранних кнопок	
19.	Наявність внутрішньої пам'яті даних із можливістю зберігання щонайменше 15 протоколів запущених програм	
20.	Мийка-дезінфікатор подає сигнали, які інформують користувача.	
21.	Моніторинг та перевірка функцій компонентів приладу та їх взаємодії відбувається автоматично і в разі відхилень на дисплеї відображається повідомлення	
22.	Кількість різних програм мийки та дезінфекції, не менше 4 шт	
23.	Мийка-дезінфікатор повинна мати забезпечувати ефективне сушіння, а саме осушення інструменту зсередини та ззовні.	
24.	Прилад автоматично розпізнає сито в основі камери для промивання.	
25.	Роз'єм для під'єднання RS 232 / USB або Ethernet –роз'єм	
26.	Приклад має забезпечувати можливість виведення протоколів на засоби виведення даних, як: <ul style="list-style-type: none"> ▪ СФ-карта ▪ комп'ютер ▪ принтер для друку протоколів 	
27.	НЕРА-фільтр, що очищує від шкідливих мікроорганізмів повітря для сушки	
28.	Двері повинні блокуватись автоматично під час виконання програми, а після завершення програми розблоковуватись автоматично	
29.	Стерилізатор має бути оснащений ручкою для аварійного відчинення дверей	
30.	Прилад оснащений вбудованою установкою пом'якшення води	

31.	Прилад має висувну секцію в нижній частині для розміщення технологічних засобів.	
32.	Мийка-дезінфікатор має забезпечувати автоматичне вимірювання електропровідності води.	
33.	Програма включає наступні етапи: попереднє очищення, очищення, нейтралізація, проміжне промивання, дезінфекція, сушіння	
34.	Ступінь захисту, не гірше IP 20	
35.	Мийка-дезінфікатор повинна бути оснащена базовим кошиком з інжекторною рейкою та фільтром з 11 фіксуючими гвинтами з нержавіючої сталі - 1 шт.	
36.	Універсальний тримач для гнучкого завантаження - 1 шт., наявність	
37.	Лоток для інструментів. Розміри (ШхВхД): 17,6 x 3 x 27,5 см - 3 шт., наявність	
38.	Гнучка корзина Для інструментів, що лежать рівно, такі як ножиці, пінцет, дзеркальця, корінцеві елеватори. Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 24 см. - 1 шт., наявність	
39.	Стандартний кошик для вертикально стоячих інструментів, таких як пінцети, зонди, дзеркальця, ножиці, затискачі та наконечники стоматологічних аспіраторів діаметром від 11 до 16 мм – 1шт, наявність	
40.	Кошик для дрібних деталей - 1 шт., наявність	
41.	Зручний кошик для дрібних речей. Розміри (ШхВхГ): 8,4 x 7,15 x 7 см – 1 шт, наявність	
42.	Тримач борів для надійного утримання обертових інструментів (наприклад, свердла) з діаметром хвостовика 1,6 мм і 2,35 мм (до 19 штук кожен) – 1 шт, наявність	

У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.

вих. № 292/02-25
від 14.02.2025 р.

м. Чернігів

Уповноваженій особі
Державна установа
«Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД», надає наступну комерційну пропозицію:


Мийка-дезінфікатор MELAtherm 10 DT B

Очищення та дезінфекція за допомогою мийки-дезінфектора MELAG є найбезпечнішим і найефективнішим способом забезпечення надійної дезактивації інструментів.

Переваги:

- **Ефективність:** Зменшення робочого навантаження та економія часу та грошей
- **Безпека:** Підвищення безпеки за рахунок мінімізації контакту персоналу з інструментами
- **Дотримання правових норм:** Реєстрація процесу дезактивації забезпечує відтворюваність
- **Оптимізація процесу:** Швидка доступність нехірургічних інструментів після автоматичного очищення та дезінфекції (відповідно до національних стандартів)

Виробництво: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
(Німеччина)

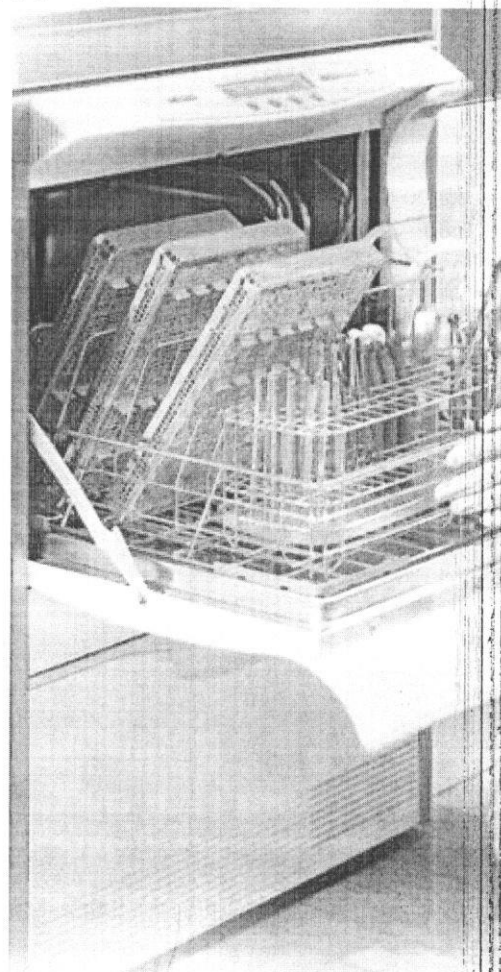

Всього з ПДВ: 705 486,15 грн. (Сімсот п'ять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 15 копійок).

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко

13.02.2025

ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Найменування: MELAtherm® 10 DT В мийка-дезінфектор

Кількість: 1

Виробник: MELAG Medizintechnik, Німеччина

Ціна: 719 595.87 грн.

**З повагою,
Директор**



І.В. Жуков


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІВЕЙ»

03083, Україна, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 34, офіс 11, тел. +38(063)372-66-50, e-mail: medivei@ukr.net
ЄДРПОУ 41728863, UA263253650000026006011081130,
ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Київ, МФО 325365,
ІПН 417288626509

13.02.2025

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ MELatherm® 10 мийка-дезінфектор

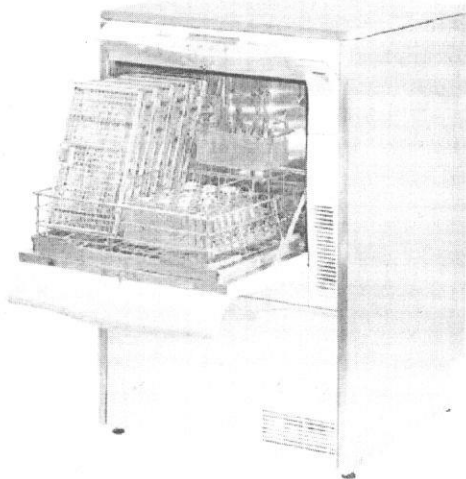

MELatherm 10 - це мийка-дезінфектор, відповідна Європейському стандарту EN 15883. Ідеально підходить для машинної обробки інструменту. Інноваційна конструкція і чудову якість Модель MELatherm® 10 призначена для швидкого, безпечного, а найголовніше - економічного знезараження інструментів. Завдяки оптимальній конструкції мийної камери і широкому вибору приладдя модель MELatherm® 10 здатна виконувати очистку і дезінфекцію величезних обсягів інструментів. Потім виконується активна сушка. В результаті всього за 60 хвилин інструменти досягають температури, що дозволяє братися за них руками без небезпеки обпектися. У мийно-дезінфекційній машині компактно розміщені всі вузли, необхідні для ефективного проведення знезараження: модель MELatherm® 10 автоматично виконує дозування обробних засобів і введення звітів, в яких фіксуються

параметри процесу обробки. Це заощаджує дорогоцінний час, дозволяючи медичному персоналу виконувати важливіші обов'язки.

Основні переваги:

- Технологія активної сушки
- Висувна корзина з вбудованими датчиками
- Наявність вимірювального модуля і пристрої для подачі обробних коштів вбудовані інтерфейси документування процесів
- Мийна камера оптимальної конструкції

Всього: 733 705,00 грн з ПДВ (Сімсот тридцять три тисячі сімсот п'ять гривень 00 копійок).

Директор ТОВ «Медівей»



Ю.С.Капась