

Заступнику начальника ДУ «ТМО МВС  
України по Чернігів. обл.» з медичних  
питань - лікарю

**Наталії Рахінській**

## **Доповідна записка**

**Про необхідність придбання мийно автоклаву  
класу В для поліклініки  
ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»**

З метою дотримання вимог наказу МОЗ № 552 від 11.08.2014 року "Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я», наказу МОЗ України №739 від 30.10.2011 року №739 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру» для забезпечення якісної стерилізації стоматологічного інструментарію існує потреба в придбанні автоклаву класу В. Автоклави класу "В": мають функцію фракціонованого передвакууму та функцію вакуумного сушіння, що різко підвищує проникаючу здатність пари, стерилізують будь-які форми медичних виробів та тканин: масивні, порожнисті, пористі, упаковані в індивідуальне або подвійне упакування будь-якого типу.

Код ДК 021:2015-33190000-9; НК 024:2023-38671

**Сестра медична  
старша поліклініки**

**Олена МИХАЙЛІЧЕНКО**

ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-168 від 18.02.2025 (8477)

Підписав: Михайліченко Олена Юріївна

Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000B47C2401A0FB7A05

Дійсний: з 07.10.2024 08:28:45 по 07.10.2025 20:59:59



## ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

### Стерилізатор паровий (код за ЕЗС ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні) (код за НК 024:2023:38671 Стерилізатор паровий)

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Стерилізатор паровий	шт.	1

#### Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису/специфікації українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати:*

*завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту,*

*або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту при поставці товару.*

3. Проведення доставки, інсталяції та запуску обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

4. Гарантійний термін обслуговування повинен бути не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.*

5. Обов'язкове проведення навчання медичного та технічного персоналу Замовника роботі на поставленому обладнанні за кошти Учасника (надати гарантійний лист про навчання персоналу Замовника).

6. Товар, що пропонується повинен бути новим, рік випуску не раніше 2024 р., а також таким, що не використовувався в якості демонстраційного зразку. (надати гарантійний лист).

7. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника або уповноваженого представника, (офіційно уповноваженого на це виробником), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.*

### Медико-технічні вимоги:

Учасник надає заповнену нижче таблицю за підписом уповноваженої особи та печаткою (в разі наявності):

№ п/п	Найменування медико-технічних вимог	Наявність функції або величина характеристики/ параметру	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника
1.	Стерилізатор паровий призначений для використання в медичній сфері	відповідність	
2.	Для якісної стерилізації інструменту автоклав виконує стерилізацію з використанням методу фракціонованого вакууму	відповідність	
3.	Автоклав працює за принципом односторонньої подачі-зливу води, щоб для кожного процесу стерилізації подавалась свіжа порція демінералізованої або дистильованої живильної води	відповідність	
4.	Стерилізатор паровий має інтегровану систему генерації пари для отримання пари	наявність	
5.	Автоклав має внутрішній бак для живильної води і резервуара для стічної води	відповідність	
6.	Ширина стерилізатора має бути не більше	47 см	
7.	Висота стерилізатора має бути не більше	50 см	
8.	Глибина стерилізатора не менше	64 см	
9.	Діаметр камери	25 ± 2 см	
10.	Глибина камери	45 ± 2 см	
11.	Об'єм камери має бути не менше	22 літрів	
12.	Вага стерилізатора в порожньому стані, не більше	50 кг	
13.	Наявність не менше ніж 5 програми стерилізації - Універсальна В програма, тривалість стерилізації 5:30 хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар; - Швидка В програма, тривалість стерилізації 5:30 хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар; - Швидка S програма, тривалість стерилізації 3:30 хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар; - Щадна В програма, тривалість стерилізації 20:30 хв, температура 121°C, тиск стерилізації 1,1 бар; - Пріонна В програма, тривалість стерилізації 20:30 хв, температура 134°C, тиск стерилізації 2,1 бар.	відповідність	
14.	Програма виконується за три основні фази: фаза відведення повітря та нагрівання, фаза стерилізації та фаза сушіння	відповідність	
15.	Наявність не менше 2 тестових програм - Випробування вакуумом - Тест Bowie Dick (Боуї — Діка)	відповідність	

16	Для зменшення часу виконання програми та отримання кращих результатів стерилізації в автоклаві можна активувати автоматичне попереднє нагрівання	відповідність	
17	Пристрій оснащений охолоджувачем, що розміщений на задній стінці	наявність	
18	Управління автоклавом здійснюється за допомогою кольорового сенсорного дисплею з 4,3-дюймовим екраном	наявність	
19	На правому боці дисплею знаходиться USB-порт для експорту даних та імпорту даних	наявність	
20	На нижньому краю дисплею є світлодіод статусу та світлодіод безпеки, що кольором сигналізує про різні ситуації	відповідність	
21	Під час виконання програми на дисплеї має відобразитися статус програми	відповідність	
22	Автоклав оснащений системою оцінювання стану процесу, яка зіставляє між собою параметри процесу під час виконання програми та контролює параметри щодо їхніх граничних значень	відповідність	
23	В разі, якщо параметри перевищують налаштовані межові значення, автоклав відображає попереджувальне повідомлення або повідомлення про несправність і за потреби перериває програму	відповідність	
24	Стерилізатор паровий повинен забезпечувати автоматичну перевірку якості живильної води перед кожним запуском програми	відповідність	
25	Автоклав повинен мати можливість зберігати у внутрішній пам'яті інформацію щодо не менше	100 протоколів	
26	Користувач може вибрати носій для виведення протоколів	відповідність	
27	Автоклав оснащений автоматичним блокуванням дверцят	відповідність	
28	Функція аварійного відкриття дверцят.	відповідність	
29	Автоклав повинен мати можливість ручного переривання програми.		
30	Електроживлення: 220-230 В, 50/60 Гц	відповідність	
31	Автоклав поставляється разом з тримачем /стійкою для 5 піддонів/лотків або 3 контейнерів	наявність	
32	Піддон / лоток – 5 шт.	наявність	

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.*

**Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцептуються.**

Уповноваженій особі  
Державна установа  
«Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України  
по Чернігівській області»

## Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сівер-МЕД», надає наступну комерційну пропозицію:


### Стерилізатор паровий Vacuclave 123

Стерилізатор паровий Vacuclave 123 - це нове покоління приладів MELAG - доступна модель лінійки Pro Line. Завдяки розумним концепціям експлуатації та документації, а також сучасній і надзвичайно міцній конструкції автоклави Pro Line пропонують усе необхідне для безпечної, зручної та ресурсозберігаючої стерилізації.

Переваги:

- **Потужний вакуумний процес класу В:** Надійна стерилізація до 6 кг лише на 5 лотках від 16 до 31 хвилини (плюс висихання за часом).
- **Розумний сенсорний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням:** Сенсорний екран із інтуїтивно зрозумілою структурою меню для легкого керування, також і на вашому смартфоні.
- **Підключення та реєстрація даних:** Відповідність вимогам законодавства шляхом збереження параметрів стерилізації через USB-накопичувач або мережу.
- **Автономна концепція:** Вбудовані резервуари для води та високоефективне повітряне охолодження для незалежної роботи без охолодження води.
- **Енергозберігаючий режим Power Save:** Нагрівання та дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями для максимальної енергоефективності.

ДИРЕКТОР  
КЛИМЕНКО О. І.

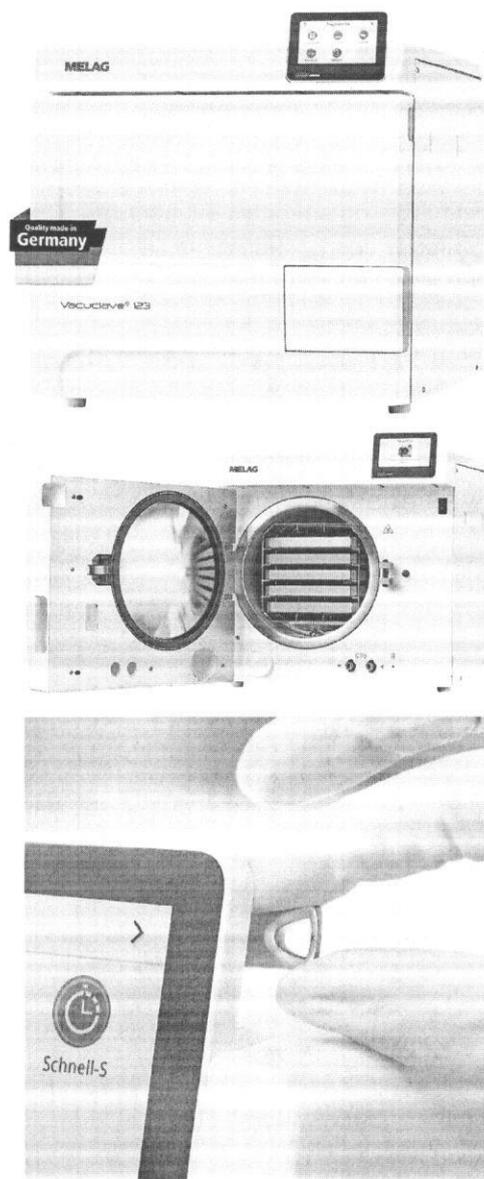

ТОВ «Сівер-МЕД» 14005, м. Чернігів, Проспект Миру 44

Відділ продажу: (073) 103-10-08, Відділ сервісу: (073) 103-10-38, siver-med@ukr.net, www.siver-med.com  
ЄДРПОУ 35194534, IBAN UA323510050000026006129539400, в АТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005

- **Концепція EasyCare:** Зручні оптимізації для ефективної заміни фільтрів, очищення бака та водопостачання.

Виробництво: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG (Німеччина)

Всього з ПДВ: 328 095,00\* грн. (Триста двадцять вісім тисяч дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).

\*Вартість вказана за модель Vasuclave 123 в комплекті зі стійкою для лотків та 5 лотками

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



О.І. Клименко



м. Бровари


14.02.2025

Державній установі  
«Територіальне медичне об'єднання  
Міністерства внутрішніх справ України  
по Чернігівській області»

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Vacuclave 123 універсальний автоклав класу В – чудове рішення для щоденної практики. Є найкращим за співвідношенням ціна-якість.


Вражає великою місткістю завантаження, чудовими результатами сушіння та розширеними функціями перевірки.

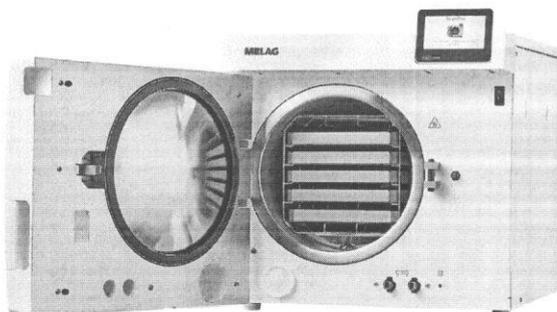

- Гарантія 12 місяців
- Безкоштовна доставка
- Безкоштовне введення в експлуатацію та навчання персоналу
- Сертифікована сервісна служба
- Сервісна підтримка в гарантійний та післягарантійний період

№	Найменування	Кількість	Ціна за шт., з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1	Vacuclave 123 автоклав Melag, 23 літра (клас В)	1	334656.00	334656.00
Загальна вартість				334656.00

Директор

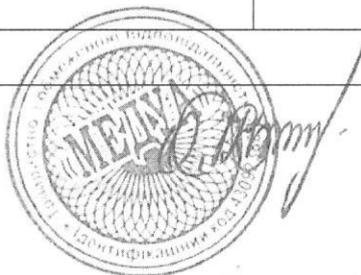

Олена КИРИЧЕНКО

ТОВ «МЕДУА», ЄДРПОУ 43092388  
Юр. адреса: м. Бровари, вул. Шолом  
Алейхема, 93, корп. 1 оф. 10  
Пошт. адреса: 02100, Київ, а/б 130



тел. +38 098 501 20 47  
р/р UA15334851000000026009264120  
АТ «ПУМБ»  
office@medua.ua

**ТОВ «НВП «АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ»**


02094, Україна, м. Київ, пр-т Гагаріна Юрія, 14, к.32 тел/ факс: (044) 573-31-50  
 тел. 050-352-39-86, <https://alcont-profitest.prom.ua/> email: [alkoservis@bigmir.net](mailto:alkoservis@bigmir.net)

Від 14.02.2025

ДУ «ГМО МВС України по Чернігів. обл.»

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**


№	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн	Загальна вартість, грн
1.	Vacuclave 123 автоклав Melag, 23 літра, автономний	1	шт	337 937,00	337 937,00
Загальна сума пропозиції:					337 937,00

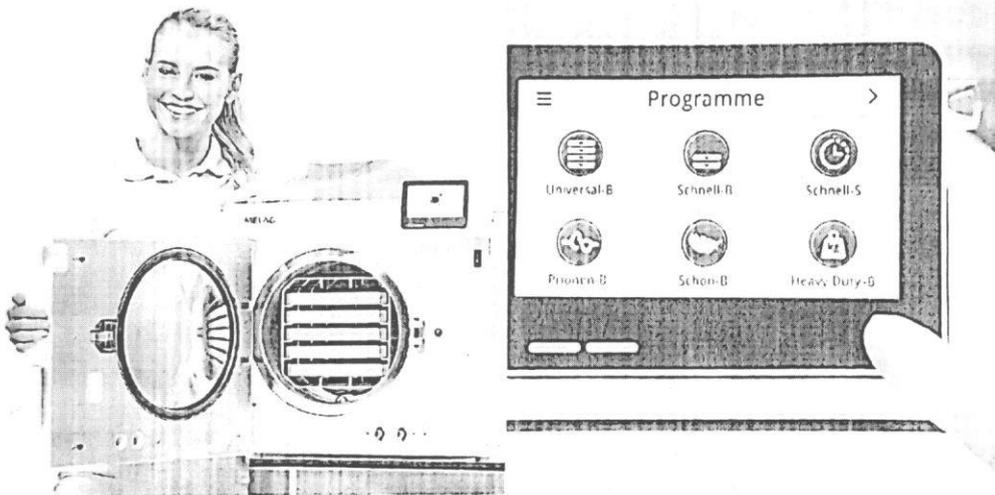

**Технічні характеристики**

Тип пристрою	Автономний
Обсяг камери	Довжина 45 см x діаметр 25 см / 23 л
Завантаження	6 кг інструментів, 2 кг текстильних виробів
Габаритні розміри пристрою (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	Пристрій розміщується на стільниці 60 см 49 кг
Електроживлення	230 В / 50/60 Гц

Директор  
 ТОВ «НВП «Академія медтехнологій»

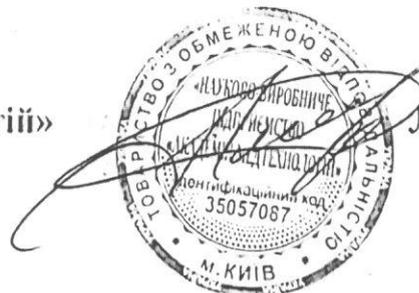

Л. М. Гордіснко