

Начальнику ДУ «ТМО МВС
України по
Чернігів. обл.» - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

Доповідна записка

Про необхідність придбання обладнання для відділення ФРМ поліклініки

З початком повномасштабного вторгнення до установи крім пацієнтів з соматичними захворюваннями, звертаються пацієнти з пораненнями різних ступенів складності, котрі потребують різнонаправленого реабілітаційного лікування. У зв'язку з цим, зросла кількість процедур, що призначаються для лікування. З метою забезпечення безперебійної та якісної роботи відділення ФРМ для надання медичної допомоги пацієнтам, які звертаються до установи та відповідно до наказів МОЗ України:

- №761 від 09.05.2022року «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану »;
- №734 від 31.10.2011року «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування», прошу закупити Апарат для ультразвукової терапії.

Начальник поліклініки-лікар



Галина МИРОНЕНКО

17.03.2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

I. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Апарат для ультразвукової терапії (код за ЕЗС ДК 021:2015: 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) (код за НК 024:2023:11248 Ультразвукова система для фізіотерапії)

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Підтвердження відповідності медико-технічним характеристикам, запропонованого Учасником товару, надається Учасником за підписом та печаткою (у разі наявності) у формі заповненої таблиці наведеної нижче:

№	Характеристики	Вимоги	Відповідність, вказати ТАК/НІ з посиланням на сторінку (розділ) відповідного документу
1.	Частота ультразвуку	1 МГц та 3,3 МГц	
2.	Максимальна інтенсивність ультразвуку:	3 Вт/см ² при 1 МГц, 1,5 Вт/см ² при 3,3 МГц	
3.	Ефективна площа випромінювання	5 см ² та 2,5 см ² ± 20%	
4.	Частота імпульсів:	СW, 5%, 10%, 20%, 30% та 50%	
5.	Імпульсна частота звуку:	100 Гц ± 5%	
6.	Аплікатор:	титанова поверхня ультразвукової головки	
7.	Клас захисту ультразвукового датчика	IP X7	
8.	Вага	Не менше 4,5 кг без комплектуючих	
9.	Дисплей:	10.1" тонкоплівковий світлодіодний з сенсорним кольоровим екраном	
10.	Мова меню	Українська	
11.	Наявність в комплекті поставки	Ультразвукова головка 5 см ² Ультразвукова головка 2,5 см ² Гель для ультразвуку, пляшка 250 м Силовий кабель	Учасник повинен надати Гарантійний лист

II. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНИМ ТА ЯКІСНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран не розглядаються та не акцентуються.

ТОВ "Медгарант"
вул. Дніпровська
набережна, 26,
м. Київ 02132

МЕДГАРАНТ

тел: (044) 585-10-70,
факс: (044) 585-10-71
sales@medgarant.net.ua
www.medgarant.net.ua

Вих. №096 від 17.03.2025

Керівнику ДУ "Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ
України по Чернігівській області"

Апарат ультразвукової терапії SONOSTAT® TOUCH

(виробник GBO Medizintechnik AG Німеччина)


Ультразвукова головка виготовлена з високоякісного титану.

Підігрів поверхні головки перед процедурою

Меню апарату українською мовою

Вбудовані терапевтичні програми

10-дюймовий TFT LCD кольоровий сенсорний дисплей

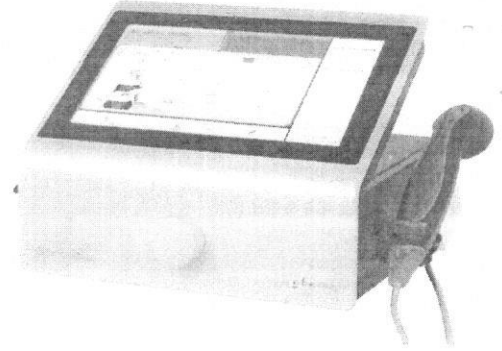

Сучасний високотехнологічний дизайн апарату з алюмінієвої основи та 10-дюймовий TFT LCD повно кольоровий сенсорний дисплей є важливими якісними характеристиками нового Sonostat®.

Sonostat® з двома частотами, 1 МГц та 3,3 МГц, кожна з яких має різний вплив на глибину, пропонує високий ступінь функціональності та зручність керування для універсальної ультразвукової терапії. Терапія за допомогою ультразвукової головки проводиться за допомогою ергономічних і 100% водонепроникних лікувальних головок розміром 2,5 см або 5 см.

Лікувальна головка виготовлена із високоякісного титану. На відміну від звичайних алюмінієвих головок, титан є біоінертним, тобто на 100% біосумісним зі шкірою, набагато міцнішим і, отже, набагато довговічнішим.

Два роз'єми для підключення головок	5 см ² та 2.5 см ²
Максимальна інтенсивність ультразвуку:	3 Вт/см ² при 1 МГц, 1,5 Вт/см ² при 3,3 МГц
Частота імпульсів:	CW, 5%, 10%, 20%, 30% та 50%
Ультразвукова частота:	1 МГц/3,3 МГц
Габарити:	27 см × 19,3 см × 28 см (Ш × В × Г)
Вага:	4,9 кг без комплектуючих
Напруга в електромережі та частота:	100 - 240 В 50-60 Гц

Sonostat 032-0-3000	1	032-0-3020 Ультразвукова головка 5 см ²	Ціна, грн з ПДВ 220 000,00
	1	023-0-0140 Ультразвукова головка 2.5 см ²	
	1	45-39-128E725 Гель для ультразвуку, пляшка 250 мл	
	1	027-4-6001 Кабель живлення	
		032-7-0015 Інструкція	

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

Вх. № 687

« 17 » 03 2025 р.

Кількість арк. _____

Осн. док. « _____ » Дод. « _____ »

Директор ТОВ «Медгарант»



Ольга КРИВОКОБИЛЬСЬКА

ТОВ "МЕД ТЕХНОЛОДЖІ"
Україна, 01054, м.Київ, вул. Леонтовича, 6-А, оф. 3
+38 (044) 599-79-62
+38 (098) 605-79-62
mtech_head@ukr.net
med-technology.com.ua
Медичне та лабораторне устаткування

MED TECHNOLOGY

LLC "MED TECHNOLOGY"
Ukraine, 01054, Kyiv, Leontovycha St. 6-A, office 3
+38 (044) 599-79-62
+38 (098) 605-79-62
mtech_head@ukr.net
med-technology.com.ua
Medical and laboratory equipment

Вих№
Від 14.03.2025 р.

Державна установа "Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Чернігівській області"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Найменування	Кількість, шт.	Ціна за од., грн. з ПДВ 7%	Сума, грн. з ПДВ 7%
1.	АПАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ SONOSTAT <u>в комплекті:</u> Апарат, ультразвукова головка 5 см ² , ультразвукова головка 2.5 см ² , гель для ультразвуку, пляшка 250 мл, кабель живлення	1	225 000,00 €	225 000,00 €
Всього з ПДВ 7%				225 000,00 €

Дата 12.11.2024.

Ціна включає: доставку по території України, інсталяцію та навчання персоналу роботи.

Гарантія: 12 міс.

Умови оплати: 100% передоплата, або згідно умов договору.

Термін поставки: в залежності від дати розміщення замовлення.

ДИРЕКТОР ТОВ «МЕД ТЕХНОЛОДЖІ» **САВЧЕНКО М.Є.**



Державна установа «Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»
Вх. № 686
« 14 » 03 2025 р.
Кількість арк. _____
Дод. « »

№ 140325 від 14.03.2025

Керівнику Чернігівської МТО МВС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Апарат ультразвукової терапії GBO Sonostat Touch


- Ультразвукова головка виготовлена з високоякісного титану
- Підігрів поверхні головки перед процедурою
- Меню апарату українською мовою
- Вбудовані терапевтичні програми
- 10-дюймовий TFT LCD кольоровий сенсорний дисплей

Сучасний високотехнологічний дизайн апарату з алюмінієвої основи і 10-дюймовий TFT LCD повнокольорний сенсорний дисплей є важливими якісними характеристиками нового Sonostat.

Sonostat з двома частотами, 1 МГц і 3 МГц, кожна з яких має різний вплив на глибину, пропонує високу ступінь функціональності і зручність керування для універсальної ультразвукової терапії.

Терапія за допомогою ультразвукової головки проводиться за допомогою ергономічних і 100% водонепроникних лікувальних головок розміром 2,5 см² або 5 см².

Лікувальна головка виготовлена з високоякісного титану. На відміну від звичайних алюмінієвих головок, титан є біоінертним, тобто на 100% біосумісним зі шкірою, набагато міцнішим і, отже, набагато більш довговічним і нетямніє.

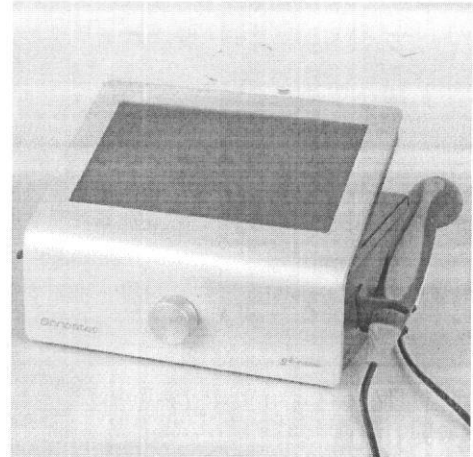

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напруга в електромережі і частота: 100 – 240 В 50-60 Гц
- Споживання потужності: макс. 120 ВА
- Максимальна інтенсивність ультразвуку: 3 Вт/см² при 1 МГц, 1,5 Вт/см² при 3,3 МГц
- Частота імпульсів: CW, 5%, 10%, 20%, 30% та 50%
- Ультразвукова частота: 1 МГц / 3,3 МГц
- Габарити: 27 см × 19,3 см × 28 см (Ш × В × Г)
- Вага: 4,9 кг без комплектуючих

Вартість з ПДВ, грн: 227 000,00

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»			
Вх. №	685		
« 14 »	03.		2025 р.
Кількість арк.			
Осн. док. «			Дод. «

Директор ТОВ «МК ВІКТОРІ»



Кисельов В.В.