

Начальнику ДУ «ТМО МВС
України по Чернігів. обл.» - лікареві
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

**Про необхідність придбання
комбінованого холодильника
для зберігання компонентів крові**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2025 року N 254 «Деякі питання реалізації донорської крові та компонентів крові суб'єктами системи крові, що здійснюють заготівлю, переробку, тестування, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові» та наказу МОЗ України від 05.02.2025 № 395 "Про затвердження Примірного таблицю матеріально-технічного оснащення лікарняного банку крові закладу охорони здоров'я, що надає послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові" та необхідністю організувати лікарняний банк крові у лікарні установи прошу закупити комбінований холодильник з морозильною камерою на 280-400 л. з вбудованим моніторингом температури (+2...+8°C/ -10...-40°C).

**Завідувач терапевтичним
відділенням - лікар**

Олена НЕМЧЕНКО



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-250 від 25.03.2025 (9112)

Підписав: Немченко Олена Іванівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000043A930006779D700

Дійсний: з 06.08.2024 08:08:59 по 06.08.2026 08:08:59

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

I. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Комбінований холодильник з морозильною камерою на 450 л. (+/- 10 л.) температурний режим R:+2...+8°C, F:-10...-40°C (код за ЕЗС ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні) (код за НК 024:2023:60607 Холодильник / морозильник для зберігання крові / компонентів крові))

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження Учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника:

Комбінований холодильник з морозильною камерою на 450 л. (+/- 10 л.) температурний режим R:+2...+8°C, F:-10...-40°C	Відповідність у запропонованому обладнанні так/ні
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен бути призначена для зберігання зразків, що вимагають температурних умов в межах Холодильна камера R:+2...+8°C, Морозильна камера F:-10...-40°C	
Загальний корисний об'єм має бути 450л	
Корисний об'єм Холодильної камери R:+2...+8°C, - 225 л. (+/- 10 л.) Морозильної камери F:-10...-40°C - 225 л. (+/- 10 л.)	
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен мати вагу нетто не більше 160 кг	
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен бути вертикального типу	
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен мати два компресора.	
Температурний режим R:+2°C ...+8°C, F:-10°C ...-40°C з точністю температури до 0,1 °C	
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен бути оснащений дверним замком з ключем	
Комбінований холодильник з морозильною камерою повинен бути оснащений тестовим портом доступу	
Зовнішній матеріал: РСМ	
Внутрішній матеріал: алюмінієва плита з напиленням	
Кількість полиць – 3 од.	
Кількість кошиків – 6 од.	
Система освітлення світлодіодна	
Наявність цифрового дисплею	
Система звукової та візуальної сигналізації	

Сигнал підвищеної температури	
Сигнал пониженої температури	
Сигнал про несправності сенсора	
Сигнал відкритих дверей	
Сигнал про відключення живлення	
Реєстрація даних USB / запис кожні 10 хвилин / 2 роки	
Вбудований резервний акумулятор для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення (до 72 годин)	
Екологічний холодоагент	
Наявність коліщат	
Наявність регулюючих ніжок	

II. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНИМ ТА ЯКІСНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволим для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. *Ця вимога підтверджується копією декларації та/або сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753).*
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. *Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.*
5. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо Учасник не є виробником товару), або офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (*надати оригінал такого гарантійного листа*).
6. Наявність інструкції (паспорта) з експлуатації запропонованого товару українською мовою (*надати копію*).
7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника. *Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист.*
8. Інструктаж спеціалістів Замовника за рахунок Учасника (*надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції*).

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз **«або еквівалент»**.

**Товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки
Іран не розглядаються та не акцептуються.**

Державна установа
«Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Чернігівській області»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


Дозвольте засвідчити Вам свою глибоку повагу та звернутися з наступною пропозицією:

Комбінований холодильник з морозильною камерою на 450 літрів (модель YCD-FL450)

Виробник: Meiling Cryogenics Limited Company, Китай

Товар сертифікований на території України

ЦІНА: 134 999,76 грн

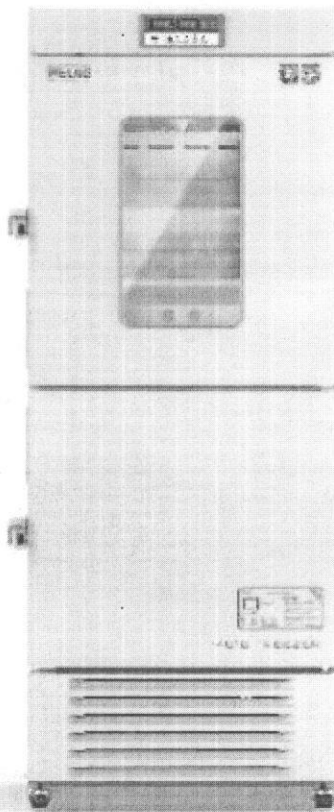

Підходить для заморожування речовин, що потребують зберігання при низьких температурах, таких як реагенти тощо. Використовуються у лабораторіях, лікарнях та інших установах охорони здоров'я та профілактики захворювань, науково-дослідних установах, коледжах та університетах тощо.

Технічні характеристики	
Модель	YCD-FL450
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	450, R:225, F:225
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	R:650*570*627, F:650*570*627
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	810*735*1960
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	895*820*2135
Вага нетто/брутто	146/173
Продуктивність	
Температурний режим °C	R:+2...+8, F:-10...-40
Температура зовнішнього середовища °C	+16...+32
Продуктивність охолодження °C	R:+5; F:-40
Кліматичний клас	N
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	2
Охолодження повітря	R: примусове; F:пряме
Режим розморожування	R: автоматичний; F:ручний
Холодоагент	R:R600a, F:HC
Товщина ізоляції (мм)	R:80, F:80

Директор ТОВ «Сівер-МЕД»



Клименко О.І.



м. Бровари

Комерційна пропозиція

Комбінований холодильник з морозильною камерою на 450 літрів (модель YCD-FL450)



Технічні характеристики	
Модель	YCD-FL450
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	450,R:225,F:225
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	R:650*570*627, F:650*570*627
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	810*735*1960
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	895*820*2135
Вага нетто/брутто	146/173

ТОВ «МЕДУА»
ЄДРПОУ 43092388
м.Бровари, вул. Шолом
Алейхема 93, офіс 10
Пошт.адреса: 02100, Київ, а/с 130




р/р UA15334851000000026009264120
АТ «ПУМБ»
тел. +38 098 501 20 47
office@medua.ua



Найменування	Кількість	Од. виміру	Ціна, грн
Комбінований холодильник з морозильною камерою ТМ Meling на 450 л. (Re225 л. /Fr225 л.)	1	шт	160 800,0

З повагою, директор

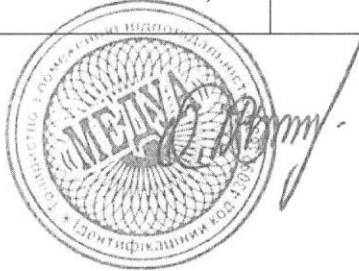

Олена КИРИЧЕНКО

ТОВ «МЕДУА»
ЄДРПОУ 43092388
м.Бровари, вул. Шолом
Алейхема 93, офіс 10
Пошт.адреса: 02100, Київ, а/с 130



р/р UA15334851000000026009264120
АТ «ПУМБ»
тел. +38 098 501 20 47
office@medua.ua

ФОП Федяков С.В.

Україна, 01042, місто Київ, вул. Маккейна Джона, будинок 37а, квартира 33, тел.+38 (098)0792501

E-mail: tender.fs.ukraine@gmail.com РНОКПП 2528702711


Номер рахунку: № UA053005280000026009000015634 в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528

Україна, 01033, м. Ки'їв, вул. Жиланська, 43 Ідент. код за ЄДРПОУ 21685166

Від 11.04.2025

ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

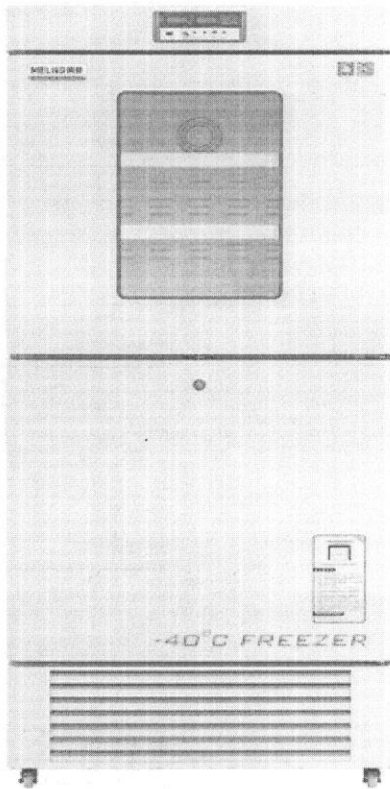

- Підходить для заморожування речовин, що потребують зберігання при низьких температурах, таких як реагенти тощо.
- Використовуються у лабораторіях, лікарнях та інших установах охорони здоров'я та профілактики захворювань.
- Дві окремих системи охолодження: одна забезпечує температуру від 2 до 8°C, а інша підтримує температуру від -10°C до -40°C. Якщо один компресор пошкоджений, інший працює.
- Холодильник має два компресори та роздільне управління верхньою холодильною камерою та нижньою морозильною камерою.
- Система оснащена звуковою та візуальною сигналізацією.
- Функція інтервального захисту від затримки пуску компресора та зупинки для забезпечення надійної роботи.
- Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню.
- Резервний акумулятор на 72 години для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення.

Виробник: Zhongke Meiling Cryogenics Company Limited (Китай)

№	Найменування	Кількість	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн	Загальна вартість, грн
1.	YCD-FL450 Комбінований холодильник з морозильною камерою на 450 літрів	шт	1	148 997,50	148 997,50
Загальна вартість					148 997,50

ФОП Федяков Сергій Вікторович



Сергій ФЕДЯКОВ